

Göteborg 2010-04-16

Övergång till analys av antikroppar mot enbart deaminerad Gliadin IgG

Laboratoriet för klinisk immunologi analyserar från och med april 2010 enbart IgG antikroppar mot deaminerad Gliadin och inte som tidigare kombinationen IgA+IgG. Denna förändring görs mot bakgrund av att internationella publikationer och vår egen interna utredning noterat att analys med enbart IgG ger en lägre andel falskt positiva resultat än analys med en kombination av IgA+IgG.


De nya referensvärdena för IgG antikroppar mot deaminerad Gliadin är:

Negativ: < 7 U/mL
Gränsvärde: ≥ 7 – 10 U/mL
Positiv: >10 U/mL

Liksom tidigare kommer alla prov för analys av antikroppar mot deaminerad Gliadin och Transglutaminas att screenas för IgA-brist.

I samband med denna förändring har vi bytt leverantör av kit för analys av antikroppar mot deaminerad Gliadin så att antikroppar mot Transglutaminas och deaminerad Gliadin analyseras med samma instrument (ImmunoCAP 250) vid ett och samma tillfälle.

Vi hoppas att denna förändring kommer att förbättra kvaliteten och förkorta svarstiden för denna analys. Vid frågor eller kommentarer hör gärna av er till laboratoriet.

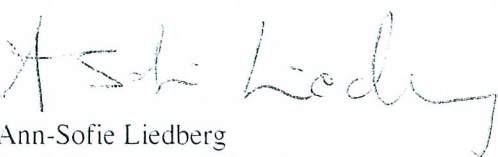

/Ann-Sofie Liedberg
Specialistläkare Klinisk Immunologi